



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 084/2022 de fecha 28 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. N° 084-037/2022

POR LA QUE SE APRUEBAN LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 07/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”; Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2701/2022, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 14 de diciembre de 2022, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1238/2022, de fecha 12 de diciembre de 2022, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación de la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”; y la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y


CONSIDERANDO: Que, se realizan las modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego, en atención a las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y a las respuestas remitidas vía Correo Electrónico Institucional, por la Unidad Solicitante, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, se realizan las siguientes modificaciones:

- *En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas;*
- *En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas en el punto Plan de entrega de los bienes;*

Que, en atención a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) sino que la misma es descargada del Sistema de

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

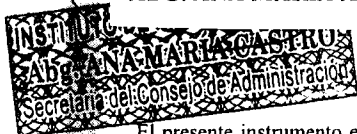

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 084/2022 de fecha 28 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. N° 084-037/2022

Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 07/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 06 (seis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Aprobar la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/lz/jo.-

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE CALIDAD DEL IPS – AD REFERENDUM 2023”


MODIFICACION PARCIAL

1-En la Sección *Suministros requeridos - especificaciones técnicas en el punto Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas se realizan las siguientes modificaciones:*

Donde dice:

LOTE 1

Ítem	1	Estufa de cultivo con CO2	cod	41104506-003	
Especificaciones Técnicas					
1	1	Datos Generales			
1	1.1	Descripción: estufa al vacío, con bomba de vacío y baño con trampa fría.			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Estufa De Vacío			
1	4.2	Rango de Temperatura desde Ambiente +5°C hasta 250°C.			
1	4.3	Rango de Vacío: 0 a 0.1 MPa (Medidor de presión analógico).			
1	4.4	Controlado por microprocesador PID. Calibración de Temperatura. Ajuste automático.			
1	4.5	Panel de control intuitivo con Display LED. Resolución 1°C.			
1	4.6	Doble modo de temporizador de encendido / apagado.			
1	4.7	Función de preajuste conveniente para las 3 configuraciones de temperatura más utilizadas			
1	4.9	Ventana de vidrio templado al calor proporciona una vista clara del interior de la cámara.			
1	4.10	Cierre hermético al vacío gracias a la puerta de vidrio cargada por resorte, la junta de silicona y la manija del pestillo de botón.			
1	4.11	Puertos de vacío y venteo separados.			
1	4.12	Interfaz RS-232 para control externo y recolección de datos.			
1	4.13	La función de bloqueo del teclado evita cambios accidentales durante la operación.			
1	4.14	Funcionamiento automático después de la interrupción del suministro eléctrico			
1	4.15	Protección contra sobre temperatura y sobre corriente.			
1	4.16	Volumen mínimo de la cámara: 28 L			
1	4.17	Tamaño de la boquilla: Vacío 10 mm Ø; Venteo 10 mm Ø			
1	4.18	Rango de Temperatura Ambiente +5 a 250°C			
1	4.19	Fluctuación de Temperatura: ± 0.1 ° (a 100°C)			
1	4.20	Variación de Temperatura: ±5 ° (a 100°)			
1	4.21	Dimensiones Internas Mínimas (W×D×H): 680×453×495mm			
1	4.22	Dimensiones Externas máximas (W×D×H): 302×305×302mm			



Lic. Diego Ramírez
Dir. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


I	4.23	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50 / 60 Hz, 5.3ª			
I	4.24	Cobertor de Seguridad: En caso de que el vidrio se destruya, el marco de acero y la cubierta de lámina de policarbonato evitan que el usuario se astille.			
I	4.25	Bomba de Vacío			
I	4.26	La bomba de vacío rotativa equipada con sello de aceite de conexión directa previene el reflujo del aire, se utiliza esencialmente con hornos de vacío para lograr un mayor nivel de presión de vacío.			
I	4.27	Trampa de niebla de aceite			
I	4.28	Velocidad de Bombeo: 100 L/min			
I	4.3	Presión Máxima (Lastre de gas abierto): 5X10-3 Torr (6.7 Pa)			
I	4.3.1	Presión Máxima (Lastre de gas Cerrado): 1X10-3 Torr (1.3X10-1 Pa)			
I	4.3.2	Potencia del Motor: 400W / 0.5 HP			
I	4.3.3	Velocidad de Motor: 1,700 RPM			
I	4.3.4	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50 / 60 Hz			
I	4.3.5	Baño Para Trampa Fría			
I	4.3.6	Sistema de disolución incorporado para eliminar fácilmente el hielo o la materia sólida atascada en el baño.			
I	4.3.7	Display LED de Temperatura			
I	4.4	Fácil instalación y mantenimiento de trampas de vidrio. (dos trampas de vidrio proporcionadas)			
I	4.4.1	Rejilla frontal de liberación rápida para una fácil limpieza del condensador			
I	4.4.2	Tamaño compacto y funcionamiento silencioso.			
I	4.4.3	Baño de acero inoxidable duradero			
I	4.4.4	Tapas de acrílicas transparentes en la parte superior de la trampa de vidrio para verificar el nivel de condensación en la trampa.			
I	4.4.5	Sistema completo de protección de seguridad con alarmas de advertencia.			
I	4.4.6	Protección contra sobre calentamiento y sobre corriente			
I	4.4.7	Control de temperatura desde ambiente hasta -40°C			
I	4.4.8	Aislante: espuma de poliuretano de 30 mm de espesor			
I	4.4.9	Material Externo: Acero inoxidable pintado y horneado			
I	4.5	Volumen mínimo: 4.8 L			
I	4.5.1	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50Hz, 4.5 A			
I	4.5.2	Trampa de Vidrio de Tipo-U con Calcio cloruro como agente desecante (1 Kg)			


Debe decir:


LOTE 1

Ítem	1	Estufa de cultivo	cod	41104506-001	
Especificaciones Técnicas					
I	1	Datos Generales			
I	1.1	Descripción: Equipo diseñado para ofrecer protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos.			
I	2	Datos proveídos por el oferente			
I	2.1	Marca:			
I	2.2	Modelo:			
I	2.3	Origen:			
I	2.4	Dirección Web del fabricante:			



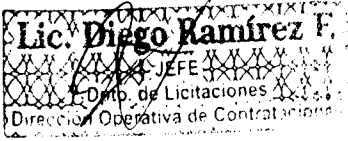

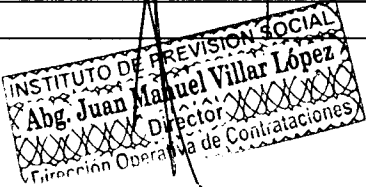

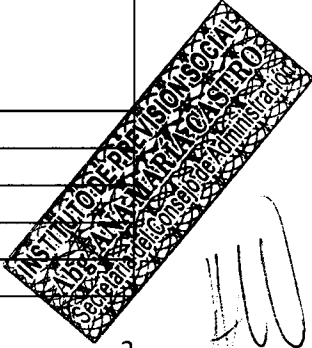

Criterios de evaluación					
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Estufa De Vacío			
1	4.2	Rango de Temperatura desde Ambiente +5°C hasta 250°C.			
1	4.3	Rango de Vacío: 0 a 0.1 MPa (Medidor de presión analógico).			
1	4.4	Controlado por microprocesador PID. Calibración de Temperatura. Ajuste automático.			
1	4.5	Panel de control intuitivo con Display LED. Resolución 1°C.			
1	4.6	Doble modo de temporizador de encendido / apagado.			
1	4.7	Función de preajuste conveniente para las 3 configuraciones de temperatura más utilizadas			
1	4.9	Ventana de vidrio templado al calor proporciona una vista clara del interior de la cámara.			
1	4.10	Cierre hermético al vacío gracias a la puerta de vidrio cargada por resorte, la junta de silicona y la manija del pestillo de botón.			
1	4.11	Puertos de vacío y venteo separados.			
1	4.12	Interfaz RS-232 para control externo y recolección de datos.			
1	4.13	La función de bloqueo del teclado evita cambios accidentales durante la operación.			
1	4.14	Funcionamiento automático después de la interrupción del suministro eléctrico			
1	4.15	Protección contra sobre temperatura y sobre corriente.			
1	4.16	Volumen mínimo de la cámara: 28 L			
1	4.17	Tamaño de la boquilla: Vacío 10 mm Ø; Venteo 10 mm Ø			
1	4.18	Rango de Temperatura Ambiente +5 a 250°C			
1	4.19	Fluctuación de Temperatura: ± 0.1 ° (a 100°C)			
1	4.20	Variación de Temperatura: ±5 ° (a 100°)			
1	4.21	Dimensiones Internas Mínimas (W×D×H): 680×453×495mm			
1	4.22	Dimensiones Externas máximas (W×D×H): 302×305×302mm			
1	4.23	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50 / 60 Hz, 5.3ª			
1	4.24	Cobertor de Seguridad: En caso de que el vidrio se destruya, el marco de acero y la cubierta de lámina de policarbonato evitan que el usuario se astille.			
1	4.25	Bomba de Vacío			
1	4.26	La bomba de vacío rotativa equipada con sello de aceite de conexión directa previene el reflujo del aire, se utiliza esencialmente con hornos de vacío para lograr un mayor nivel de presión de vacío.			
1	4.27	Trampa de niebla de aceite			
1	4.28	Velocidad de Bombeo: 100 L/min			
1	4.3	Presión Máxima (Lastre de gas abierto): 5X10-3 Torr (6.7 Pa)			
1	4.3.1	Presión Máxima (Lastre de gas Cerrado): 1X10-3 Torr (1.3X10-1 Pa)			
1	4.3.2	Potencia del Motor: 400W / 0.5 HP			
1	4.3.3	Velocidad de Motor: 1,700 RPM			
1	4.3.4	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50 / 60 Hz			
1	4.3.5	Baño Para Trampa Fría			
1	4.3.6	Sistema de disolución incorporado para eliminar fácilmente el hielo o la materia sólida atascada en el baño.			
1	4.3.7	Display LED de Temperatura			
1	4.4	Fácil instalación y mantenimiento de trampas de vidrio. (dos trampas de vidrio proporcionadas)			
1	4.4.1	Rejilla frontal de liberación rápida para una fácil limpieza del condensador			

Lic. Diego Ramírez F.
JEFE
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

1	4.4.2	Tamaño compacto y funcionamiento silencioso.			
1	4.4.3	Baño de acero inoxidable duradero			
1	4.4.4	Tapas de acrílicas transparentes en la parte superior de la trampa de vidrio para verificar el nivel de condensación en la trampa.			
1	4.4.5	Sistema completo de protección de seguridad con alarmas de advertencia.			
1	4.4.6	Protección contra sobre calentamiento y sobre corriente			
1	4.4.7	Control de temperatura desde ambiente hasta -40°C			
1	4.4.8	Aislante: espuma de poliuretano de 30 mm de espesor			
1	4.4.9	Material Externo: Acero inoxidable pintado y horneado			
1	4.5	Volumen mínimo: 4.8 L			
1	4.5.1	Requerimientos Eléctricos: 230V, 50Hz, 4.5 A			
1	4.5.2	Trampa de Vidrio de Tipo-U con Calcio cloruro como agente desecante (1 Kg)			

Donde dice:

LOTE 4

ítem	1	TERMO HIGRÓMETRO	cód.	41112301-001	
Especificaciones Técnicas					
1	1	Datos Generales			
1	1.1	Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de medir la temperatura y humedad relativa del ambiente.			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Termohigrómetro de mesa y pared			
1	4.2	El soporte plegable.			
1	4.3	Carcasa de plástico robusta y resistente al agua, ofrece una larga vida útil.			
1	4.4	Display LCD dual para la humedad y temperatura.			
1	4.5	Cuenta con función de memoria para lecturas de máximos y mínimos de temperatura con alarma.			
1	4.6	Los valores de °C y °F son intercambiables mediante el panel de control frontal			
1	4.7	Rango de medición de humedad: 10% HR y 99% HR			
1	4.8	Precisión de Humedad: ±1% HR			
1	4.9	Rango de medición de Temperatura (°C): - 50 a +70°C			
1	4.10	Precisión (°C): ± 0,1°C			
1	4.11	Rango de medición de Temperatura (°F): - 58 a +158°F			
1	4.12	Precisión (°F): ± 0,2°F			


Lic. Diego Ramírez
JEFE
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Debe decir:

LOTE 4

ítem	1	TERMO HIGRÓMETRO	cód.	41112301-001	
Especificaciones Técnicas					
1	1	Datos Generales			
1	1.1	Descripción: Dispositivo diseñado para uso en laboratorios con el fin de medir la temperatura y humedad relativa del ambiente.			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Termohigrómetro de mesa y pared			
1	4.2	El soporte plegable.			
1	4.3	Carcasa de plástico resistente al agua.			
1	4.4	Display LCD dual para la humedad y temperatura.			
1	4.5	Cuenta con función de memoria para lecturas de máximos y mínimos de temperatura con alarma.			
1	4.6	Los valores de °C y °F son intercambiables mediante el panel de control frontal			
1	4.7	Rango de medición de humedad: 10% HR y 99% HR			
1	4.8	Precisión de Humedad: ±1% HR			
1	4.9	Rango de medición de Temperatura (°C): - 50 a +70°C			
1	4.10	Precisión (°C): ± 0,1°C			
1	4.11	Rango de medición de Temperatura (°F): - 58 a +158°F			
1	4.12	Precisión (°F): ± 0,2°F			

2- En la Sección **Suministros requeridos Especificaciones Técnicas. Plan de entrega de los bienes se realiza la siguiente modificación:**

Donde dice:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	DISTRIBUCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA (DÍAS)	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION (DÍAS)	REQUIERE INSTALACION EDILICIA	REQUIERE CAPACITACIONES
								(SI/NO)	(SI/NO)
1	1	41104506-003	ESTUFA DE SECADO. ESTUFA DE SECADO AL VACÍO. CAPACIDAD 28 LITROS. CON BOMBA DE VACÍO CON TRAMPA FRÍA.	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
2	1	41111709-001	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
3	1	41115807-9996	EQUIPO ANALIZADOR DE POLIMEROS Y GOMAS.	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
4	1	41112301-001	TERMO HIGRÓMETROS CALIBRADOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD). TERMOHIGRÓMETRO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	5	90	30	NO	SI
5	1	41105101-003	BOMBA DE VACÍO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
6	1	24112402-9999	ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA DISOLVENTES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI

Lic. **Diego Ramírez F.**
JEFE
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. **Juan Manuel Villar López**
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. **ANA MARIA CASTRO**
Secretaria del Consejo de Administración

7	1	40101902-001	DESHUMIDIFICADOR PARA LABORATORIO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
8	1	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS DE PTFE DE 45/25 DE 0,45MM PARA JERINGA, PARA HPLC	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS PARA SOLVENTES HPLC DE CELULOSA 0,45MM X 47 MM	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	3	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	4	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 SHIEL BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	5	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC HILIC (CROMATOGRAFIA DE INTERSECCION HIDROFILICA) 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	6	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH SHIELD RP 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	7	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH C8 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Debe decir:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	DISTRIBUCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA (DÍAS)	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION (DÍAS)	REQUIERE INSTALACION EDILICIA	REQUIERE CAPACITACIONES
								(SI/NO)	(SI/NO)
1	1	41104506-001	Estufa de cultivo	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
2	1	41111709-001	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUETO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
3	1	41115807-9996	EQUIPO ANALIZADOR DE POLIMEROS Y GOMAS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
4	1	41112301-001	TERMO HIGROMETROS CALIBRADOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD) TERMOHIGROMETRO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	5	90	30	NO	SI
5	1	41105101-003	BOMBA DE VACÍO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
6	1	24112402-9999	ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA DISOLVENTES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
7	1	40101902-001	DESHUMIDIFICADOR PARA LABORATORIO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
8	1	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS DE PTFE DE 45/25 DE 0,45MM PARA JERINGA, PARA HPLC	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS PARA SOLVENTES HPLC DE CELULOSA 0,45MM X 47 MM	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	3	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	4	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 SHIEL BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	5	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC HILIC (CROMATOGRAFIA DE INTERSECCION HIDROFILICA) 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	6	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH SHIELD RP 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	7	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH C8 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

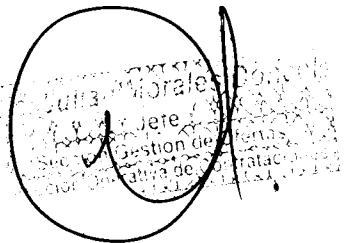

Lic. Diego Ramírez F.
JEFE
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Naraiza O. Lugo
Secretaria de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIOS

Donde dice:


LOTE 1


ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	41104506-003	ESTUFA DE SECADO. ESTUFA DE SECADO AL VACÍO. CAPACIDAD 28 LITROS, CON BOMBA DE VACÍO CON TRAMPA FRÍA.	UNIDAD	UNIDAD	1	280.666.667	280.666.667

Debe decir:

LOTE 1

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	<u>41104506-001</u>	<u>ESTUFA DE CULTIVO</u>	UNIDAD	UNIDAD	1	280.666.667	280.666.667


Julian Morales
Jefe
Sección Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Diego Ramirez F.
JEFE
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración