



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 019-018/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7; Y SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1 Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA N° 441/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 08 de marzo de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 0063/2023, de fecha 02 de marzo de 2023, del Departamento de Licitaciones - Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a conocimiento de la Máxima Autoridad, la ratificación de las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7; y a consideración la solicitud de aprobación de la Aclaración N° 1 y la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023"; y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, consistieron en prórrogas a las fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales obedecieron a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente Regulador, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en atención a las aclaraciones remitidas por el Administrador del Contrato en atención a las consultas realizadas, por potenciales oferentes. Además se menciona que el plazo de publicación de cada adenda de prórroga es de 01 (un) día de verificación y 05 (cinco) días de publicación;

Que, la Aclaración N° 1, y la Modificación Parcial, representan aclaraciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), que son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 019-018/2023

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3º) Ratificar la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 4º) Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 019-018/2023

- 5º) Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 6º) Ratificar la Adenda N° 6, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 7º) Ratificar la Adenda N° 7, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 8º) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 9º) Aprobar la Modificación Parcial, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023", en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 05 (cinco) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 019-018/2023

- 10º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 11º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/ta/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 1

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
Jefa
Sec. Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones


Ma. Julia Morales Dorado
Directora General de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALEJANDRA MARIACA
Secretaria del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alejandra Mariaca
Secretaria del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 2

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ma. Mercedes Miracca
Jefa
Sec. Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones


Juan Morales Dorico
Director General


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Secretaría de Contratación


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANEXAMA LAMARCA PRO
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C.A.P. - Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 3

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
María Dolores Miracca
Jefa de
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones


María Julia Morales
Secretaría de
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Secretaría de
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALBA ANA C. JARAMILLA
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C-123456789
Página Web IPS



ADENDA N° 4

AL OFERENTE:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma Dolores Miracca
Jefe de
Sección de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

The Julian Morales Somoza



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A GRAN MAJAL CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 5

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:


Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
María Dolores Miracca
Jefa
Sección de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Juan Morales Donato
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GABRIELA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 6

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ma. Yvelina Morales
Secretaría de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Julian Morales
Director General de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALBERTO J. MACASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución

Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 7

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
Sec. Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Juan Morales Bonchi
Intendente de la Unidad Ejecutiva
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Juan Morales Bonchi
Intendente de la Unidad Ejecutiva
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Argentina Martínez
Secretaría del Comité de Administración

Resolución C.A. Pagina Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADUISION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS – AD REFERENDUM 2023”

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de de 2023.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADUISION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS – AD REFERENDUM 2023”, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 3.

Lote 8 Ítem 3. Favor confirmar que la columna requerida es 1,7 um.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 4

Lote 8 Ítem 4. Favor confirmar que columna requerida es 1,7 um.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 5

LOTE 8. ITEM 5. Favor confirmar que la columna requerida es 1,7 um.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 6

LOTE 8. ITEM 6. Favor confirmar que la precolumna requerida es BEH shield RP 18 de 1,7 um.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 3

LOTE 8. ITEM 7. Favor confirmar que la Pre columna requerida es BEH C8, considerando que la columna BEH solicitada en el ítem 3 es C18.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 7


LOTE 8 ITEM 7. Favor confirmar que la pre columna requerida es 1,7 um

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.


CONSULTA 7

En los requisitos de capacidad técnica solicitan:

- c - La empresa deberá presentar certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dispositivos médicos.
- d - La empresa deberá presentar Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.
- e - Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección General


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


Lic. Julio Morales Doncel
Dirección de Servicios Técnicos


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Control de Calidad

f - Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.

Solicitamos a la convocante no considerar estos requisitos, ya que los equipos solicitados no son dispositivos de uso médico, sino de laboratorio. O indicar en cuales ítems serán necesarios estos requisitos

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8 – ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificaciones técnicas: Donde dice: Platina De doble placa con movimientos coaxiales X&# 8208; Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.H26Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X‐Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Se solicita amablemente a la convocante considerar: Platina De doble placa con movimientos coaxiales X‐ Y, 150 x 139 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 9 – ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificaciones técnicas:

Donde dice: Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA120V, 50/60 Hz.

Se solicita amablemente a la convocante considerar solicitar cargador por panel solar para 6 horas de operación continua que a la vez incluya fuente de poder y cables USB. Puesto que es una tecnología amigable con el medio ambiente y que no desperdicia materiales como baterías AA. Todo esto sin modificar el precio referencial.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere con "estuche con 5 preparaciones".

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 11 – LOTE 1 1 ITEM PUERTOS DE VACIO Y VENTEO SEPARADOS.

LOTE 1 ITEM 1 ¿A qué se refiere con Puertos de vacío y venteo separados?

Respuesta: Se aclara que se refiere a que las líneas, de vacío y liberación, deben estar separadas. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12 - LOTE 1 ITEM 1 CONSIDERAR FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA

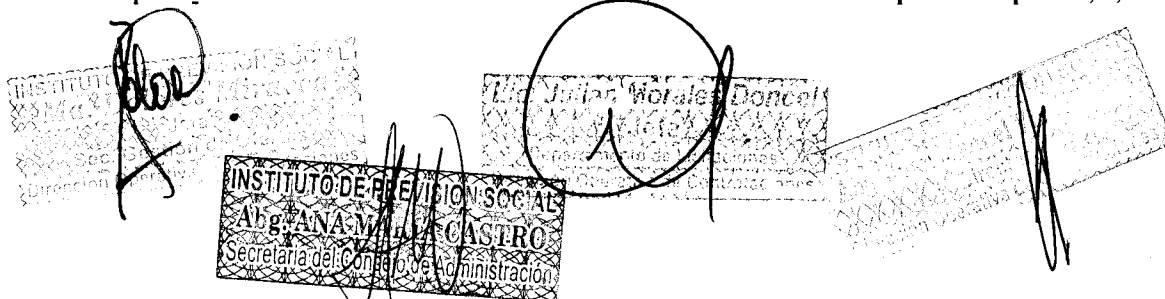
Lote 1 Ítem 1. Se debe considerar Fluctuación de Temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (a 100°C) o variación de temperatura: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (a 100°C)?

Respuesta: Se aclara que se deben considerar ambas. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 13 - LOTE 1 ITEM 1 VOLUMEN MÍNIMO DE LA CÁMARA

LOTE 1 ITEM 1. Se especifica volumen mínimo de la cámara: 28 L. Sin embargo, también se menciona como volumen mínimo: 4.8 L, ¿este sería referente a la cámara o al equipo en sí?

Respuesta: Se aclara que el volumen de la cámara es de vacío 28L, y el volumen del baño para trampa fría, 4,8 L



CONSULTA 14 - LOTE 1 ITEM 1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTUFA

Lotè 1 Ítem 1 Desde la sección 1 4,25 bomba de vacío hasta la sección 1 4.5.2 Trampa de Vidrio de Tipo-U, se estaría refiriendo a características de la estufa de cultivo propiamente dicha o sería un error de tipeo?

Respuesta: Se aclara que la sección 4.25 a 4.34 se refiere a las especificaciones técnicas de la Bomba de vacío, desde 4.3.5 hasta 4.5.2 se refiere a las especificaciones técnicas de la trampa fría, ambas deben formar parte del equipo. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15 – LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON OCULARES DE GRAN CAMPO

Lote 2 Ítem 1 se podría admitir un equipo con oculares de gran campo WF 10x / 18 mm?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 16 – LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON PLATINA

Lote 2 Ítem 1 ¿se podría admitir un equipo con platina de 115 x 100 mm?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 17 – LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON OCULARES DE GRAN CAMPO

Favor aclarar a que se refiere con estuche con 5 preparaciones. Filtros amarillo, azul y verde serian para el sed polarización/contraste de fases?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.

CONSULTA 18 – LOTE 2 ITEM 1 FILTROS AMARILLO, AZUL Y VERDE ADAPTABLES

Lote 2 Ítem 1 serían filtros amarillo, azul y verde adaptables y/o extraíbles?

Respuesta: Se aclara que son filtros adaptables y extraíbles

CONSULTA 19 – LOTE 2 ITEM 1 M.O. CON DISTANCIA INTER PUPILAR DE 48 A 75 MM

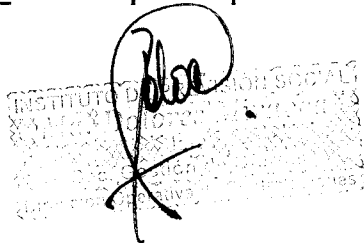
Lote 2 Ítem 1 ¿se podría admitir un M.O. con IPD 55-75 mm?

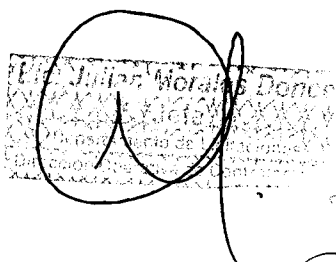
Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

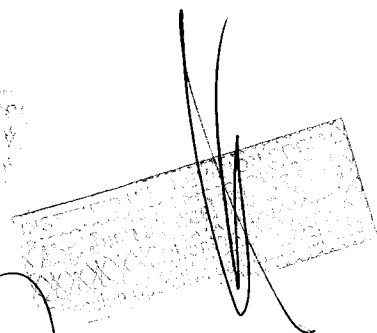
CONSULTA 20 – LOTE 2 ITEM 1 M.O. CON ALIMENTACION: 3 BATEIRAS AA RECARGABLES DE 1.2 V.

Lote 2 ítem 1 se podría considerar un M.O. que solo posee entrada de alimentación 220V CA. Fuente de alimentación universal opcional 110 V-240 V CA, sin baterías recargables?

Respuesta: Se aclara que se requiere con baterías recargables. Para la presentación de ofertas.









LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS – AD REFERENDUM 2023”

MODIFICACION PARCIAL

1-En la Sección Suministros y Especificaciones técnicas punto Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas:

Donde dice:

LOTE 2

Ítem	1	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICO	Cód.	41111709-001	
Especificaciones Técnicas					
1	1	Datos Generales			
1	1.1	Descripción: Microscopio Binocular			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.			
1	4.2	Con tratamiento antifúngico.			
1	4.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados.			
1	5	Tubo binocular			
1	5.1	-Oculares: WF10X / 20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno del os oculares.			
1	5.2	Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm.			
1	5.3	Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.			
1	5.4	Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación.			
1	5.5	Cuerpo: Estativo y reforzado con acabado en pintura epóxica.			
1	6	Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.H26Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.			
1	6.1	Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Equipado con soporte adaptador para kit de contraste de fases o set de polarización.			
1	7	Diafragma: De iris con porta filtros.			
1	7.1	Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.			
1	7.2	Iluminación: Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.			
1	8	Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA120V, 50/60 Hz.			
1	8.1	ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable trifásico. Funda de plástico. Aceite de inmersión. Instructivo en español. Estuche con 5 preparaciones. Filtro amarillo, azul y verde.			
1	8.2	Kit de limpieza.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mg. Carlos Miranda
Jefe de Oficina
Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contrataciones

Udo Julian Morales Doncel
Jefe de Oficina
Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mg. Carlos Miranda
Jefe de Oficina
Gestión de Ofertas
Sección Operativa de Contrataciones

Debe decir:

LOTE 2

Ítem	1	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICO	cod	41111709-001	
		Especificaciones Técnicas			
1	1	Datos Generales			
1	1.1	Descripción: Microscopio Binocular			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
		Criterios de evaluación			
1	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1	4	Características			
1	4.1	Estativo metálico, cuerpo del microscopio ergonómico.			
1	4.2	Con tratamiento antifúngico.			
1	4.3	Sistema de protección de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados.			
1	5	Tubo binocular			
1	5.1	-Oculares: WF10X / 20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.			
1	5.2	Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm.			
1	5.3	Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.			
1	5.4	Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación.			
1	5.5	Cuerpo: Estativo y reforzado con acabado en pintura epóxica.			
1	6	Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 a 139 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.H26Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 a 139 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.			
1	6.1	Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Equipado con soporte adaptador para kit de contraste de fases o set de polarización.			
1	7	Diafragma: De iris con porta filtros.			
1	7.1	Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.			
1	7.2	Iluminación: Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.			
1	8	Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA120V, 50/60 Hz.			
1	8.1	ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable trifásico. Funda de plástico. Aceite de inmersión. Instructivo en español. Filtro adaptables y extraíbles amarillo, azul y verde.			
1	8.2	Kit de limpieza.			

Donde dice:

LOTE 8

ITEM	SIH	SAP	DNCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	11281	12000651	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo. Filtros de PTFE de 45/25 de 0,45µm para jeringa, para HPLC	Caja X 100 unidades	Filtro para cromatógrafo
2	11282	12000652	41115716-003	Filtro para Cromatógrafo. Filtros para solventes HPLC de celulosa 0,45µm x 47 mm	Caja X 100 unidades	Filtro para cromatógrafo
3	10959	12000599	41115711-9999	Columnas de Uplc C18 BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	- Columna para Cromatografía Liquida
4	10960	12000600	41115711-9999	Columnas de Uplc C18 shiel BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	- Columna para Cromatografía Liquida
5	10963	12000603	41115711-9999	Columnas de Uplc HILIC (cromatografía de intersección hidrofílica) 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	- Columna para Cromatografía Liquida
6	10966	12000606	41115717-9998	Adaptador para Cartucho Precargado (precolumna) BEH shield RP 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	Adaptador para Cartucho Precargado (pre columna)
7	10967	12000607	41115717-9998	Adaptador para Cartucho Precargado (precolumna) BEH C8 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	Adaptador para Cartucho Precargado (pre columna)

Debe decir:

LOTE 8

Ítem	SIH	SAP	DNCP	Descripción Original del CBDM	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	11281	12000651	41115716-003	Filtros de PTFE de 45/25 de 0,45µm para jeringa, para HPLC	Caja X 100 unidades	
2	11282	12000652	41115716-003	Filtros para solventes HPLC de celulosa 0,45µm x 47 mm	Caja X 100 unidades	
3	10959	12000599	41115711-9999	Columnas de uplc C18 BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	<u>Tamaño de poro recomendada 1,7 um.</u>
4	10960	12000600	41115711-9999	Columnas de uplc C18 shiel BEH C18 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	<u>Tamaño de poro recomendada 1,7 um.</u>
5	10963	12000603	41115711-9999	Columnas de uplc HILIC (cromatografía de intersección hidrofílica) 1,0 x 100 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	<u>Tamaño de poro recomendada 1,7 um.</u>
6	10966	12000606	41115717-9998	precolumnas BEH shield RP 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	<u>Precolumna BEH shield o HILIC. Porosidad minina posible de 1,7 um</u>
7	10967	12000607	41115717-9998	precolumnas BEH C8 2,1 x 5 mm compatible con equipo WATER Acquity	Unidad	<u>Precolumna BEH shield o HILIC. Porosidad minina posible de 1,7 um</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Dirección General de Previsión Social

Lic. J. J. Morales Donato
Director General de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Dirección General de Previsión Social
Secretaría de Asesoría y Administración

2- En la Sección Suministros y Especificaciones técnicas punto Plan de entrega de los bienes se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	DISTRIBUCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA (DÍAS)	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION (DÍAS)	REQUIERE INSTALACION EDILICIA	REQUIERE CAPACITACIONES
								(SI/NO)	(SI/NO)
1	1	41104506-001	Estufa de cultivo	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
2	1	41111709-001	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
3	1	41115807-9996	EQUIPO ANALIZADOR DE POLÍMEROS Y GOMAS.	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
4	1	41112301-001	TERMO HIGRÓMETROS CALIBRADOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD). TERMOHIGRÓMETRO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	5	90	30	NO	SI
5	1	41105101-003	BOMBA DE VACÍO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
6	1	24112402-9999	ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA DISOLVENTES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
7	1	40101902-001	DESHUMIDIFICADOR PARA LABORATORIO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
8	1	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS DE PTFE DE 45/25 DE 0,45MM PARA JERINGA, PARA HPLC	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS PARA SOLVENTES HPLC DE CELULOSA 0,45MM X 47 MM	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	3	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	4	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 SHIELD BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	5	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC HILIC (CROMATOGRAFÍA DE INTERSECCIÓN HIDROFÍLICA) 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	6	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH SHIELD RP 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	7	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH C8 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Debe decir:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	DISTRIBUCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA (DÍAS)	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION (DÍAS)	REQUIERE INSTALACION EDILICIA	REQUIERE CAPACITACIONES
								(SI/NO)	(SI/NO)
1	1	41104506-001	Estufa de cultivo	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	120	30	NO	SI
2	1	41111709-001	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
3	1	41115807-9996	EQUIPO ANALIZADOR DE POLIMEROS Y GOMAS.	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	120	30	NO	SI
4	1	41112301-001	TERMO HIGRÓMETROS CALIBRADOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD). TERMOHIGRÓMETRO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	5	90	30	NO	SI
5	1	41105101-003	BOMBA DE VACÍO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	120	30	NO	SI
6	1	24112402-9999	ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA DISOLVENTES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
7	1	40101902-001	DESHUMIDIFICADOR PARA LABORATORIO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
8	1	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS DE PTFE DE 45/25 DE 0,45MM PARA JERINGA, PARA HPLC	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS PARA SOLVENTES HPLC DE CELULOSA 0,45MM X 47 MM	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	3	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	4	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 SHIEL BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	5	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC HILIC (CROMATOGRAFIA DE INTERSECCIÓN HIDROFÍLICA) 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	6	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH SHIELD RP 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	7	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH C8 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.C. [illegible]
Sec. [illegible]
Dirección [illegible]


Lic. [illegible]
[illegible]
[illegible]


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
A. [illegible]
Secretaría del Consejo de Administración


[illegible]

Debe decir:

LOTE	ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	DISTRIBUCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA (DÍAS)	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION (DÍAS)	REQUIERE INSTALACION EDILICIA	REQUIERE CAPACITACIONES
								(SI/NO)	(SI/NO)
1	1	41104506-001	Estufa de cultivo	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	120	30	NO	SI
2	1	41111709-001	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
3	1	41115807-9996	EQUIPO ANALIZADOR DE POLÍMEROS Y GOMAS.	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	120	30	NO	SI
4	1	41112301-001	TERMO HIGRÓMETROS CALIBRADOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD). TERMOHIGRÓMETRO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	5	90	30	NO	SI
5	1	41105101-003	BOMBA DE VACÍO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	120	30	NO	SI
6	1	24112402-9999	ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA DISOLVENTES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	30	NO	SI
7	1	40101902-001	DESHUMIDIFICADOR PARA LABORATORIO	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	30	NO	SI
8	1	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS DE PTFE DE 45/25 DE 0,45MM PARA JERINGA, PARA HPLC	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	2	41115716-003	FILTRO PARA CROMATOGRAFO. FILTROS PARA SOLVENTES HPLC DE CELULOSA 0,45MM X 47 MM	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	3	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	4	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC C18 SHIEL BEH C18 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	5	41115711-9999	COLUMNAS DE UPLC HILIC (CROMATOGRAFIA DE INTERSECCION HIDROFILICA) 1,0 X 100 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	1	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	6	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH SHIELD RP 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	7	41115717-9998	ADAPTADOR PARA CARTUCHO PRECARGADO (PRECOLUMNA) BEH C8 2,1 X 5 MM COMPATIBLE CON EQUIPO WATER ACQUITY	DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD	2	90	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Angélica María Castro
Secretaría de Administración

Dr. Julio Morales Domínguez
Presidente del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Angélica María Castro
Secretaría de Administración