



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 081/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-023/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1, Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 100/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS”, CON ID N° 473.508.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2380/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 03 de noviembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1328/2025, de fecha 03 de noviembre de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación de la Aclaración N° 1 y la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 100/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS”, con ID N° 473.508; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaración N° 1, representan aclaraciones sobre las Bases y Condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes, la respuesta suministrada (remitida a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, la modificación parcial representa modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, garantizando así sus conformidades, en los términos del Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administración del IPS y del Memorando DOP/DLI1/N° 1328/2025, de fecha 03 de noviembre de 2025, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS

LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-023/2025

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 100/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 11 (once) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Aprobar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 100/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS”, con ID N° 473.508, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 10 (diez) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-
- 3º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/rr/jo.-

FDG.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS

LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

Secretaria del Consejo de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 100/25 “ADQUISICION DE EQUIPOS
ODONTOLOGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508.-

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de Noviembre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 100/25 “ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA N° 1

Título: ITEM 5 (3.1) EETT: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garanticen su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 2

Título: ITEM 5 (4.1) EETT: Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

CONSULTA: Se sugiere amablemente a la convocante permitir la presentación de autoclave con capacidad de hasta 25 litros. Esto permitirá que más oferentes proveedores de Instituciones de Salud puedan participar del llamado.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 3

Título: ITEM 6 (3.1) EETT: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garanticen su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 4

Título: ITEM 6 (4.1) EETT: Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

CONSULTA: Se sugiere amablemente a la convocante permitir la presentación de autoclave con capacidad de hasta 25 litros. Esto permitirá que más oferentes proveedores de Instituciones de Salud puedan participar del llamado.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 5

Título: Consulta: Para las destiladoras, Selladoras, y Lavadoras Ultrasonicas

Se sugiere amablemente considerar la posibilidad de dejar sin efecto la solicitud del certificado bajo normas ISO 13485, CE o FDA, teniendo en cuenta que ciertos equipos, como las selladoras, destiladoras y lavadoras, no son considerados equipos electromédicos y, por tanto, no se encuentran sujetos a dichos requerimientos normativos.


Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 6

Título: ítems 2 Compresor de 1HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS , y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

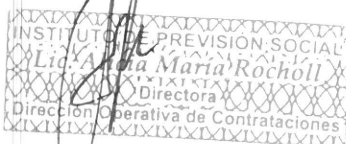



CONSULTA N° 7

Título: Ítems 3 Compresor de 10 HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 8

Título: Ítems 4 Secadora para compresor de 10 HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 9

Título: Ítems 8 Sellador para Esterilización

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 10

Título: Ítems 9 Ultrasonido

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 11

Título: Ítems 12 Equipo Destilador

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 12

Título: Ítems 1 Sillon Odontológico

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 13

Título: Ítems 5 Autoclave de Vapor

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 14

Título: Ítems 6 Autoclave de Vapor

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



CONSULTA N° 15

Título: Items 7 Autoclave de vapor

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 16

Título: Ítems 7 Autoclave de vapor

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 17

Título: Items 10 Equipo de Fotopolimerizador

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 18

Título: Items 11 Equipo Quita Sarro

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 19

Título: Items 13 Equipo de RAYOS X Portatil Odontologico

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 20

Título: Items 14 Turbina Odontológica

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y también por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos médicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 21

Título: Items 15 Kit de Micromotor y contraangulo

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl Abg. Jaime Caballero
Directora Gerente
Dirección Operativa de Contrataciones Gerencia de Abastecimiento y Logística

Página 3 de 11

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. AINA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



CONSULTA N° 22

Título: Items 16 Set de Equipos Odontológicos

Piden Certificado de la FDA, CE y JIS y también por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos médicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 23

Título: Items 5 Autoclave de Esterilización de vapor

Piden Certificado de Calidad e inspección técnica, a que se refiere esto?

Respuesta: *Se aclara que cualquier equipo de vapor a presión debe cumplir con procesos de validación para evitar explosiones que destruyan vidas humanas y materiales (ASME, CE PED etc). El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.*

CONSULTA N° 24

Título: Items 6 Autoclave de Vapor

Piden Destiladora con el Autoclave ¿?, si es así todas las destiladoras trabajan a 220V y no a 24V como pide la descripción.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 25

Título: Items 6 Autoclave de Vapor

Piden Tecla press es necesaria ¿?

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 26

Título: Items 9 Lavadora de 6 litros

Piden Configuración de 40 50 hasta 60 grados. Se puede cotizar desde 50 grados en adelante ¿?

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 27

Título: Items 14 Turbina Odontológica

Piden Velocidad de 30.000 rpm, creemos fue un error de tipeo ya que las turbinas por ser de alta velocidad, se encuentran desde 250.000 rpm en adelante. Favor corregir este error.

Respuesta: *El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.*

CONSULTA N° 28

Título: Items 14 Turbina Odontológica

Sugerimos esta descripción que faltaría a la especificación técnica, ya que hubo un error en la descripción de la rotación - potencia igual o mayor a 26 W • tamaño de cabeza como máximo de 10,8 x 12,5 mm • 4 orificios de spray de refrigeración • sistema cabezal limpio • válvula anti reflujo • Válvula reguladora de presión • Rodamientos cerámicos


Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 29

Título: Items 15 Micromotor y contraángulo

Piden accesorio 10 conjuntos de rulemanes por la totalidad de los contrángulos, se entiende que si uno sale adjudicado se entregaran los 10 rulemanes por la totalidad de la adjudicación de ese ítem, favor aclarar esto.

Respuesta: *Se aclara que la cantidad de conjuntos de rulemanes en principio es de 10, en caso de avería la condición es que el equipo este operativo, aunque se necesiten en mayor cantidad. Como parte de la garantía de funcionamiento. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

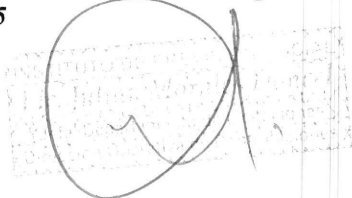



CONSULTA N° 30

Título: Items 1 Sillon Odontologico

4.1. Solicitan: . Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante. Consultas: Sugerimos estas especificaciones -La base completa debe ser totalmente protegida por bordes antideslizantes, ya que es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad del sillón, bordes antideslizantes, para así ser estables y no se vean afectados por pisos con imperfecciones? - Para lograr estabilidad y durabilidad es importante que la estructura de la base (no debe ser en forma de cruz o tipo enjambre o similar, por no dar la estabilidad necesaria tanto en el respaldo como en la base) y del respaldo fabricado en acero macizo. Por cuestiones de seguridad en caso de urgencias el sillón debería tener un boton de emergencia destacado en la base. - Es importante que los sillones sean Ambidiestro, para adaptación para diestros y zurdos. MEDIDAS DEL SILLON: la base debería tener como mínimo un espesor de 26 mm. para tener una mayor estabilidad y adherencia al suelo

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 31

Título: Documentos para Consorcio

Si bien el PBC acepta el consorcio no menciona si es consorcio Constituido o se puede presentar consorcio por intención, favor aclarar esto.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 32

Título: Items 10 Fotopolimerizador

Piden operación programable de 1 seg. , todas las Fotopolimerizadoras del mercado tienen programación desde 5 seg. Tener en cuenta y cambiar la configuración para poder cotizar los oferentes este producto.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 33

Título: Items 1 Sillon Odontologico

4.5. Solicitan: Apoyabrazos derecho e izquierdo, rebatibles. Consulta: El brazo izquierdo debe ser fijo, ya que se encuentra al lado de la unidad de agua. El paciente siempre sale por el lado derecho. Teniendo en cuenta esto solicitamos el cambio en las especificaciones técnicas

Respuesta: *El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.*

CONSULTA N° 34

Título: Items 1 Sillon Odontologico

4.7 Solicitan: Tapizado con acolchado anatómico sin costuras, en PVC, alta densidad, fácilmente desmontable. Consulta: , se recomienda agregar esta sugerencia atóxico y anti flama con protector para los pies del paciente.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 35

Título: Items 1 Sillon Odontologico

4.11. Solicitan: Posiciones de Trabajo: 5 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo Vuelta a cero Consulta: Se podría cotizar 3 o mas posiciones de trabajo programables por el odontólogo?

Respuesta: *El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.*

CONSULTA N° 36

Título: Items 1 Sillon Odontologico

Solicitan: Vuelta a cero Consulta: Al presionar esta funcion de vuelta cero debe apagar el reflector automaticamente al presionar esta funcion. ?

Respuesta: *Se aclara que en las condiciones iniciales los datos de trabajo deben volver a los valores de fábrica. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*





CONSULTA N° 37

Título: Items 1 Sillon Odontologico

6,5 Solicitan: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 42.000 Lux GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR Consulta: Podrían considerar de 8.000 a 35.000 lux

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 38

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.2 Solicitan: Escupidera de cerámica, desmontable para fácil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando manual. Consulta: La cuba es de ceramica esmaltada por completa , no comprendemos la solicitud de rejilla esmaltada

Respuesta: *Se aclara que solo la tapa de rejilla debe ser esmaltada. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 39

Título: Items 1 Sillon Odontologico

5,6 Solicitan: Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de presión. Consulta: A que se refiere cuando mencionan regulador de presión en un ultrasonido? Deberia ser regulador de potencia

Respuesta: *Se aclara que regulador de potencia es sinónimo de regulación de presión. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 40

Título: Items 1 Sillon Odontologico

4.11. Solicitan: 2 (dos) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotación con refrigeración Consulta: A que se refiere 2H?

Respuesta: *Se aclara 2 orificios (aire + agua). Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 41

Título: Items 1 Sillon Odontologico

5,5 Solicitan: 1(una) manguera con jeringa triple con 3 (tres) puntas o insertos como mínimo con regulador de agua y de potencia Consulta: que serian 3 puntas o insertos ? A que se refiere cuando mencionan regulador de potencia en una JT? Deberia ser de agua, aire y spray

Respuesta: *El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.*

CONSULTA N° 42

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.4 Solicitan: Un succionador de saliva venturi con pico de aluminio pulido. Consulta: Podrían aclarar a que se refieren con el pico de aluminio....

Respuesta: *El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.*

CONSULTA N° 43

Título: Items 1

4.6. Solicitan: Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo. Consulta: Deberia ser desmontable y regulable en altura, con movimientos frontales, posteriores y longitudinales y sistema de bloqueo de palanca para facilitar atención a los pacientes discapacitados en sillas de ruedas, que sea extraíble, lo que permite una rápida limpieza y desinfección.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andrea Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



CONSULTA N° 44

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta: Se aclara que es un depósito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 45

Título: Item 13 Rayo X Portatil

*Item 13 / Recomendamos el Rayo X Portátil con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes, practico de usar y compatible con cualquier Sensor Intraoral. Item 13.4 Punto focal: 0.4 mm Tensión del tubo 65KV Corriente del tubo 2.6 mA Alcance del tiempo de exposición: 0.01-2 segundos Filtración inherente: 0.8mmAl Filtración adicional: 1.0 mmAl Campos de rayos X: 60mm Potencia de entrada: 22.2 V Peso máximo: 2.1 KG Anillo de protección externa: La protección de retrodispersión minimiza notablemente la dosis de radiación del operador. Protección interna: La protección a la radiación interna del fuselaje está diseñada de forma óptima para proteger al operador de una fuga de radiación Dosis de exposición predeterminada: adulto o niños y selección del diente. 300 exposiciones como mínimo con una sola carga. Estacion de carga permitiendo su uso siempre que sea necesario una exposición. Estacion de carga que sirve como base para mayor comodidad. Item 13.5 Sensor Intraoral Recomendamos con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y la convocante adquirir un equipo de ultima generacion. Escala de grises: 65.536 nivel de gris (16 bits) Area de imagen como mínimo: 25*30mm2 Area del sensor como mínimo: 30*37 mm2 Espesor máximo: 5mm Formato de imagen: BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF Tamaño 1.5 Sensor intra oral con chip de silicio para evitar el desenfoco de la imagen y deterioro del rendimiento. Cable duradero de alta resistencia. Capaz de soportar tracción de hasta 10 kg. Resistencia al gua probada según IECIP IP68 con capacidad de resistir a 1 metro de agua durante 60 minutos como mínimo. Sensor con conteo de fotones. Actualizaciones de software sin costo Incluye posicionador

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 46

Título: Items 1 Sillon Odontologico

5,7 Solicitan: Con pedal neumático con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano. Consulta: PODRÍAN CONSIDERAR OTRO MATERIAL como.....: El acero inoxidable..

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 47

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.5 Solicitan: Un suctor de mayor potencia con pico de aluminio pulido con llaves de paso regulable Consulta: Podrían aclarar a que se refieren con el pico de aluminio pulido....

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

CONSULTA N° 48

Título: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el punto N° 1.4.8 dice: Peso de Trabajo: 150 Kg o más Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Peso de Trabajo: 150 Kg (+/-10)

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 49

Título: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el punto 1.6.5 dice: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 42.000 Lux GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Intensidad de iluminación: entre 10.000 y 42.000 Lux (o mayor Rango) GRADUABLE, ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 50

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta: Se aclara que es un depósito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 51

Título: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero esto ¿?

Respuesta: Se aclara que la llave de paso es importante para que el aire a presión no se desperdicie en la reposición de agua de la botella. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 52

Título: Item 5 Autoclave de 21lt.

Item 5 Autoclave de 21Litros – 5.4 Características: Recomendamos con las siguientes especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y la convocante adquirir un equipo de última generación. Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 21 litros . Comando digital- display: LCD Iluminado. 3 Programas de esterilización como mínimo. Tanque de acero inoxidable, pantalla LCD. Secado: Puerta cerrada. Esterilización; 121°C/ 1,15 Bar y 134°C/ 2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica. Seguridad; Sistema mecánicos y digitales. Potencia 1400 W. Con indicador de mantenimiento Preventivo, con contador de ciclos, con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 53

Título: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"En el punto 1.7.2 dice: Escupidera de cerámica, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando Solicitamos a la convocante que esta parte quede de la siguiente manera: Escupidera de cerámica o de Vidrio, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 54

Título: Items 1 Sillon Odontologico

8.3 Solicitan: Base metálica acero inoxidable de alta resistencia con 5 o más ruedas de silicona para fácil desplazamiento y resistencia. Consulta: Podrían considerar base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia. Debido a que la base metálica cromada pertenece a una marca especifica

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 55

Título: Items 1 Sillon Odontologico

8.3 Solicitan: Base metálica acero inoxidable de alta resistencia con 5 o más ruedas de silicona para fácil desplazamiento y resistencia. Consulta: Podrían considerar base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia. Debido a que la base metálica cromada pertenece a una marca especifica

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025





CONSULTA N° 56

Título: Autorización del Fabricante

Autorización del fabricante: En la Página 17 del PBC dice Autorización del fabricante: Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem. "Solicitamos amablemente al Convocante que para la firma de Contrato la misma se encuentre Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio".

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 57

Título: Multa

En la Página 56 del PBC dice Porcentaje de multas: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,10 % Solicitamos amablemente al Convocante que reduzca el porcentaje de multas al 0.01% por el atraso en la entrega de los bienes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 58

Título: Item 1 Sillon Odontologico

Recomendamos adaptar con estas especificaciones para dar mayor participación a los oferentes y así también la convocante adquirir un sillón de alta calidad, cualidad y resistente. Sillón Odontológico: con brazo articulado, tapizado sin costura, con sistema de freno neumatico en la platina, anclado la salivadera al sillón, con 1 reflector de led, 1 platina, 1 salivadera, 1 jeringa triple, con 5 puntas con terminal borden. El sillón sin fijación al piso. Estructura de acero con tratamiento anticorrosivo con pintura secado al horno (Esmalte Epoxi – Poliamida de alta calidad, o similar para uso Sanitario, especialmente desarrollado para proteger estructuras de hierro y acero galvanizado que estén expuestos a ambientes muy corrosivos y/o ataques químicos). Comando eléctrico en la platina con pantalla táctil, Comando digital touch, 9 programas de trabajo, sistema vuelta cero, con parada de emergencia. La Platina con bandeja de 5 soportes frontal, 4 cuatro unidades terminales borden, 1 unidad de jeringa triple, salida de las puntas con sistema neumatico, con acople tipo borden, y cabezal bi articulado para adaptarse a pacientes de diferentes estaturas, removible y reversible, para pacientes en silla de rueda, respaldo metálico, apoya brazos de alta resistencia, y lavable, capacidad de soportar 200 kilos o más. Pedal multifunción con joystick que permite el control del aire y agua al mismo tiempo, La caja de conexiones separada del sillón. El brazo del sillón articulado neumático. Con Reflector LED con 8 led, de 8.000 a 40.000 lux como mínimo, temperatura de color de 4.500 - 5.000k, ajustando la temperatura fría y cálida, encendido y apagado desde el comando digital de la platina. Regulador independiente de aire y agua para cada válvula de las piezas de mano. Sistema de agua presurizada y sistema de agua de red, pedal neumático pieza de mano progresivo (sistema microswitach) Salivadera: Bacha de cerámica desmontable, movimiento de 180 grados. con llena vaso (sistema de agua tibia o caliente). Picos de bacha y llena vaso desmontable autoclavable con filtro incorporado reusable y lavable, con banqueta para el odontólogo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 59

Título: PLAN DE ENTREGA

Solicitamos a la convocante respetuosamente que los plazos de entrega de los bienes sean de 120 días para todos los ítems a partir de la firma del contrato

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lidia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



CONSULTA N° 60

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentación de más oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 61

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia capacidad técnica punto 2 La autorización/ resolución de apertura vigente, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MÉDICOS; aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 62

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 3 Autorización de apertura y funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPByBS como fabricante, importador, representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de Dispositivos Médicos. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 63

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 4 Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4959/12. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 64

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 13 Certificado buenas prácticas de fabricación y control, si es de fabricación nacional, y buenas prácticas de almacenamiento y depósito, para los importados. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 65

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica punto 2 La autorización/ resolución de apertura vigente, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MÉDICOS. Aceptar la constancia de estar en trámite expedida por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Página 10 de 11

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



CONSULTA N° 66

Título: Muestra

Solicitamos la Presentación de las Muestra de los ítems, así la convocante puede ver in situ los equipos ofertados si cumple las especificaciones técnicas solicitadas.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 67

Título: Multa

Multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,10 % Solicitamos amablemente al Convocante que el porcentaje de multas por el atraso en la entrega de los bienes sea de 0,05% por cada día de atraso.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 68

Título: Autorización del Fabricante

Autorización del fabricante: Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS. Solicitamos al Convocante que para la firma de Contrato la misma se encuentre Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio.

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

CONSULTA N° 69

Título: CAPACIDAD TÉCNICA

Solicitamos a la convocante solicite el siguiente documento: Certificación ISO 9001:2024 de la empresa oferente vigente al momento de la apertura de ofertas

Respuesta: *El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2 Publicado en fecha 09-10-2025*

Resolución C.A. - Página Web PS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 100/25 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS", con ID 473.508.-

MODIFICACION PARCIAL

1-En la Sección Suministros requeridos – Especificaciones Técnicas – Detalle de los bienes y/o servicios, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

Item1

Sillon Odontologico

1.4 Características

- 1.4,1 Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante.
- 1.4,2 Estable, sin necesidad de fijar al piso.
- 1.4,3 Movimiento independiente entre asiento y respaldo.
- 1.4,4 Accionamiento electromecánico.
- 1.4,5 Apoyabrazos derecho e izquierdo, rebatibles.**
- 1.4,6 Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo.
- 1.4,7 Tapizado con acolchado anatómico sin costuras, en PVC, alta densidad, fácilmente desmontable.
- 1.4,8 Peso de trabajo: 150 Kg o más
- 1.4,9 Placa madre blindada antillamas. CE 434
- 1.4,10 Movimientos de los sillones: A través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y también con un panel de comando ubicado en la unidad dental.
- 1.4,11 Posiciones de Trabajo: 5 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo**
- 1.4,12VC: Vuelta a cero

1.5 CONSOLA O UNIDAD DENTAL

- 1.5,1 Movimientos horizontal y vertical, brazos articulados con freno neumático con 2 (dos) o más kg de capacidad.
- 1.5,2 Bandeja de trabajo (porta instrumental) incorporado de acero inoxidable.
- 1.5,3 2 (dos) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotación con refrigeración
- 1.5,4 (una) manguera con terminal para micromotor neumático con acople borden con refrigeración (baja rotación)
- 1.5,5 1(una) manguera con jeringa triple con 3 (tres) puntas o insertos como mínimo con regulador de agua y de potencia**
- 1.5,6 Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de presión.
- 1.5,7 Con pedal neumático con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano.

1.7 Escupidera

1
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocha
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Dirección Operativa de Contratación
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



- 1.7,1 Unidad de agua rebatible o no rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90° o más.
- 1.7,2 Escupidera de cerámica, desmontable para fácil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando manual.
- 1.7,3 Jeringa triple auxiliar.
- 1.7,4 Un suctor de saliva venturi con pico de aluminio pulido.
- 1.7,5 Un suctor de mayor potencia con pico de aluminio pulido con llaves de paso regulable.
- 1.7,6 Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de fácil acceso, extracción y limpieza
- 1.7,7
- 1.7,8 Accionamiento automático de cada suctor
- 1.7,9 Botella reservorio de agua de 1 (uno) litro o más con llave de paso.

Item2

COMPRESOR 1 HP

2.Criterios de Evaluación

2.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

Item3

COMPRESOR 10 HP

3.Criterios de Evaluación

3.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

Item4

SECADOR DE AIRE PARA COMPRESOR DE 10 HP

4.Criterios de Evaluación

4.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al 4.3.1 menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 4.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

Item5

AUTOCLAVE 18 a 21 LTS

5. Criterios de Evaluación

5.3 Normativas

Cumple Parámetros Folio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS 5.3.1 al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho 5.3.2 documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

5.4 Características

5.4.1 Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

5.4.2 Tres bandejas o más de acero inoxidable grado quirúrgico o Aluminio

5.4.3 Estructura del tanque de presión y tapa en acero inoxidable

5.4.4 Con reservorio externo incorporado para agua destilada

5.4.5 Tiempo de esterilización programables: dos o más programas

5.4.6 Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura

5.4.7 Panel frontal

5.4.8 Sistema de secado a puerta cerrada

5.4.9 Certificado de calidad e inspección técnica

Item6

AUTOCLAVE CLASE B 18 a 21 LTS

6. Criterios de Evaluación

6.3 Normativas

Cumple Parámetros Folio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS 6.3.1 al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho 6.3.2 documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.





6.4 Características

6.4,1 Capacidad del tanque 18 litros o más o más a 21 Litros o menos.

6.4,2 Tres bandejas o más de acero inoxidable grado quirúrgico o Aluminio.

6.4,3 Estructura del tanque de presión y tapa en acero inoxidable.

6.4,4 Destilador de agua por osmosis inversa de baja tensión 24v o menos, potencia de 36 W o mas.

6.4,5 Tiempo de esterilización programable: dos o más programas.

6.4,6 Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura

6.4,7 Panel frontal de simple lectura y fácil operación a través de teclas press boton.

6.4,8 Alimentación eléctrica 220 V /50 Hz

6.4,9 Potencia 1800 w o mas

6.4,1 Temperatura de esterilización 121° C a 134° C

6.4,11 Secado al vacío con puerta cerrada

6.4,12 Cámara: Aluminio o Acero Inoxidable

Item8

SELLADORA DE BOLSAS

8.Criterios de Evaluación


8.3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
8.3.1	Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.			
8.3.2	Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.			

Item9

LAVADORA 6 LITROS

9.Criterios de Evaluación

9.3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
9.3.1	Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.			

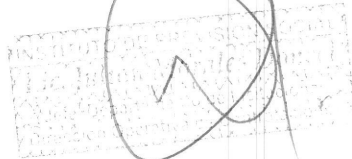



Certificado de Normas de calidad generales: ISO 9.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

Item12

DESTILADOR DE AGUA

12.Criterios de Evaluación		
12.3	Normativas	CumpleParámetrosFolio
Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS		
12.3.1	al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	
Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar		
12.3.2	marca y tipo de equipo ofertado.	

Item14

TURBINA DE ALTA ROTACION

14.4 Características	
14.4,1	Cuerpo en acero inoxidable/grado quirúrgico o en aluminio anodizado natural.
14.4,2	Con rulemanes de alta calidad.
14.4,3	Sistema de fijación de fresa: sujeción de la fresa por botón o push button.
14.4,4	Conexión tipo Borden de dos orificios de acuerdo a las normas ISO 9168
14.4,5	Velocidad de 30.000 rpm o más
14.4,6	Autoclavables a 135° C
14.4,7	Sistema de cabezal limpio con 3 o más salidas de agua.
14.4,8	Diámetro del cabezal: 10 mm o mas a 12 mm o menos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



Debe decir:

Item 1

Sillon Odontologico

1.4 Características

- 1.4,1 Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante.
- 1.4,2 Estable, sin necesidad de fijar al piso.
- 1.4,3 Movimiento independiente entre asiento y respaldo.
- 1.4,4 Accionamiento electromecánico.

1.4,5 Apoyabrazos derecho e izquierdo

- 1.4,6 Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo.
- 1.4,7 Tapizado con acolchado anatómico sin costuras, en PVC, alta densidad, fácilmente desmontable.
- 1.4,8 Peso de trabajo: 150 Kg o más
- 1.4,9 Placa madre blindada antillamas. CE 434
- 1.4,10 Movimientos de los sillones: A través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y también con un panel de comando ubicado en la unidad dental.

1.4,11 Posiciones de Trabajo: 3 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo

- 1.4,12VC: Vuelta a cero

1.5 CONSOLA O UNIDAD DENTAL

- 1.5,1 Movimientos horizontal y vertical, brazos articulados con freno neumático con 2 (dos) o más kg de capacidad.
- 1.5,2 Bandeja de trabajo (porta instrumental) incorporado de acero inoxidable.
- 1.5,3 2 (dos) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotación con refrigeración
- 1.5,4 1 (una) manguera con terminal para micromotor neumático con acople borden con refrigeración (baja rotación)

1.5,5 1 (una) jeringa triple con 3 puntas intercambiables como mínimo, y controles independientes de agua, aire y spray.

- 1.5,6 Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de presión.
- 1.5,7 Con pedal neumático con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano.

1.7 Escupidera

- 1.7,1 Unidad de agua rebatible o no rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90° o más.
- 1.7,2 Escupidera de cerámica, desmontable para fácil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con salida de agua con comando manual.
- 1.7,3 Jeringa triple auxiliar.

1.7,4 Un suctor de saliva venturi

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



1.7,5 Un suctor de mayor potencia con pico y con llaves de paso regulable.

- 1.7,6 Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de fácil acceso, extracción y
1.7,7 limpieza
1.7,8 Accionamiento automático de cada suctor
1.7,9 Botella reservorio de agua de 1 (uno) litro o más con llave de paso.

Item2

COMPRESOR 1 HP

2.Criterios de Evaluación

2.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al
2.3.1 menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar
marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
2.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y
tipo de equipo ofertado. OPCIONAL

Item3

COMPRESOR 10 HP

3.Criterios de Evaluación

3.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al
3.3.1 menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e
indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
3.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
y tipo de equipo ofertado. OPCIONAL

Item4

SECADOR DE AIRE PARA COMPRESOR DE 10 HP

4.Criterios de Evaluación

4.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al
4.3.1 menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e
indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
4.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar
marca y tipo de equipo ofertado. OPCIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana María Castro
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



Item5

AUTOCLAVE 18 a 21 LTS

5.Criterios de Evaluación

5.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, MDR, JIS, ANMAT o ANVISA al menos alguna de ellas.
5.3.1 Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho
5.3.2 documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

5.4 Características

5.4.1 Capacidad del tanque desde los 18 Litros.

5.4.2 Tres bandejas o más de acero inoxidable grado quirúrgico o Aluminio

5.4.3 Estructura del tanque de presión y tapa en acero inoxidable

5.4.4 Con reservorio externo incorporado para agua destilada

5.4.5 Tiempo de esterilización programables: dos o más programas

5.4.6 Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura

5.4.7 Panel frontal

5.4.8 Sistema de secado a puerta cerrada

5.4.9 Certificado de calidad e inspección técnica

Item6

AUTOCLAVE CLASE B 18 a 21 LTS

6.Criterios de Evaluación

6.3 Normativas

CumpleParámetrosFolio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, MDR, JIS, ANMAT o ANVISA al menos alguna de ellas.
6.3.1 Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho
6.3.2 documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado.

6.4 Características

6.4.1 Capacidad del tanque desde los 18 litros.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



- 6.4,2 Tres bandejas o más de acero inoxidable grado quirúrgico o Aluminio.
- 6.4,3 Estructura del tanque de presión y tapa en acero inoxidable.
- 6.4,4 Destilador de agua por osmosis inversa de baja tensión 24v o menos, potencia de 36 W o mas.
- 6.4,5 Tiempo de esterilización programable: dos o más programas.
- 6.4,6 Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un indicador de presión y temperatura
- 6.4,7 Panel frontal de simple lectura y fácil operación a través de teclas press botton.
- 6.4,8 Alimentación eléctrica 220 V /50 Hz
- 6.4,9 Potencia 1800 w o mas
- 6.4,1 Temperatura de esterilización 121° C a 134° C
- 6.4,11Secado al vacío con puerta cerrada
- 6.4,12Cámara: Aluminio o Acero Inoxidable

Item8

SELLADORA DE BOLSAS

8.Criterios de Evaluación		
8.3	Normativas	CumpleParámetrosFolio
8.3.1	Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	
8.3.2	<u>Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. OPCIONAL</u>	

Item9

LAVADORA 6 LITROS

9.Criterios de Evaluación		
9.3	Normativas	CumpleParámetrosFolio
9.3.1	Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.	
9.3.2	<u>Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. OPCIONAL</u>	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



Item 12

DESTILADOR DE AGUA

12. Criterios de Evaluación

12.3 Normativas

Cumple Parámetros Folio

Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS
12.3.1 al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado. OPCIONAL

Item 14

TURBINA DE ALTA ROTACION

14.4 Características

14.4.1 Cuerpo en acero inoxidable/grado quirúrgico o en aluminio anodizado natural.

14.4.2 Con rulemanes de alta calidad.

14.4.3 Sistema de fijación de fresa: sujeción de la fresa por botón o push button.

14.4.4 Conexión tipo Borden de dos orificios de acuerdo a las normas ISO 9168

14.4.5 Velocidad de 300.000 rpm o más

14.4.6 Autoclavables a 135° C

14.4.7 Sistema de cabezal limpio con 3 o más salidas de agua.

14.4.8 Diámetro del cabezal: 10 mm o mas a 12 mm o menos

Obs: Quedando los demás Ítems invariables.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración